品名: いびきストッパー
型番: EB-RM1800

取 扱 説 明 書　保証書添付

本体はいびきの音を感知し、いびきの音を3回連続感知すると電気波動を出力して、人に刺激を与えいびきを止める仕組みになっています。
いびきをかいている人の姿勢をちょっと変えるだけでいびきが止まる、というのは日常でもよく経験することです。本体は、電気波動でこれと同じような効果を発揮するものです。

次の様な方は絶対に使用しないでください。
1、心臓ペースメーカー等の体内埋込型の医療用電子機器をつけている方。
2、悪性腫瘍組織のある方。
3、心臓に障害のある方。
4、妊産婦の方
5、伝染性疾患の方。
6、厳重な皮膚病・過敏性皮膚の方・腫れ・傷・炎症のある方。
7、呼吸中止症のある方。
8、心電計等の装着医用電子機器を使用している方。
9、その他、医師の治療を受けている方や、特に体に異常を感じている方。
10、医師から心臓に注意等の指示を受けている方。
※口・目・顔・頭の上に置かないでください。

各部の名称と準備

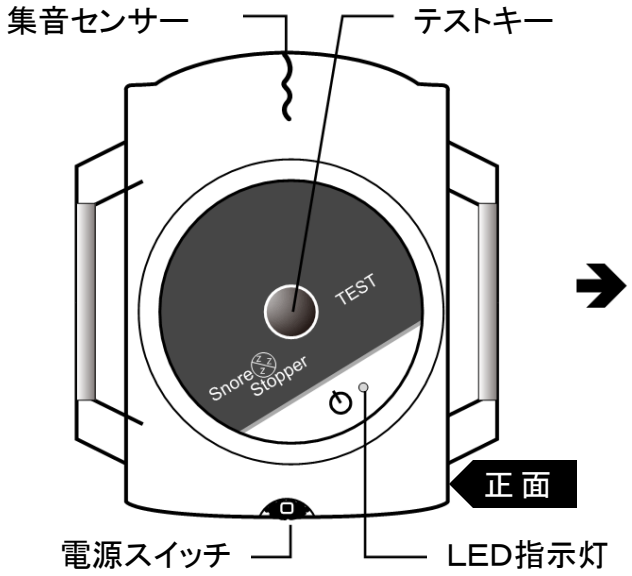
集音センサー
テストキー
TEST
Snore Stopper
正面
電源スイッチ
LED指示灯

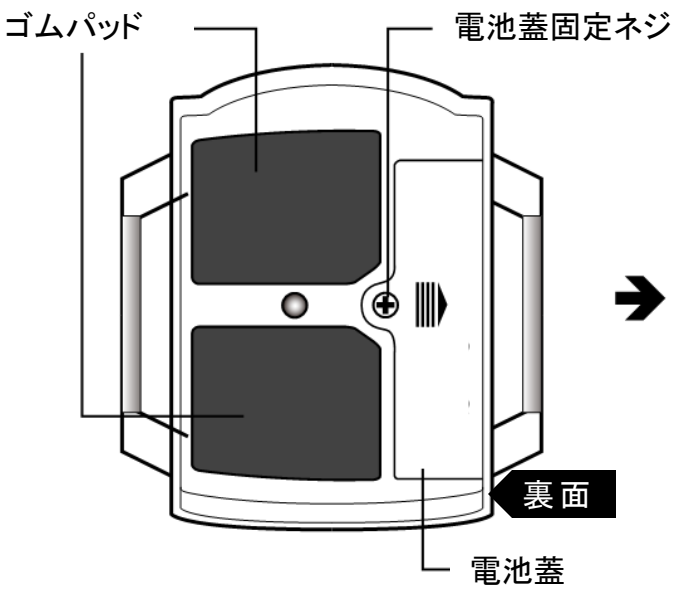
ゴムパッド
電池蓋固定ネジ
裏面
電池蓋

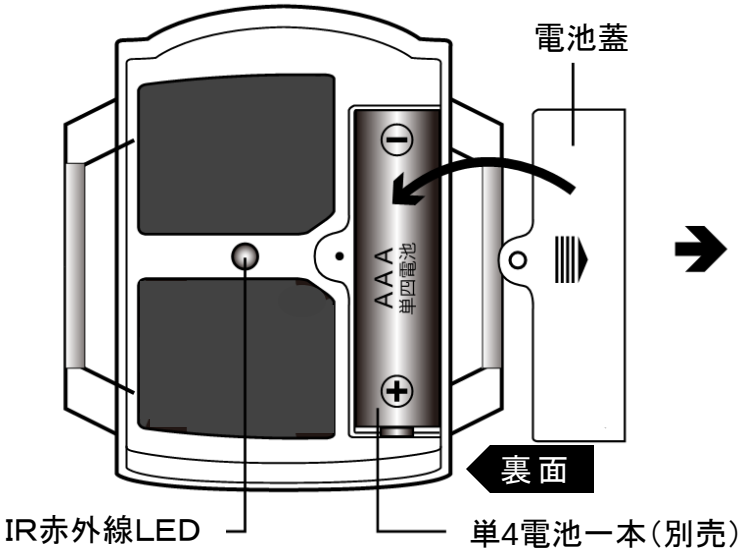
電池蓋
AAA
単四電池
裏面
IR赤外線LED
単4電池一本（別売）

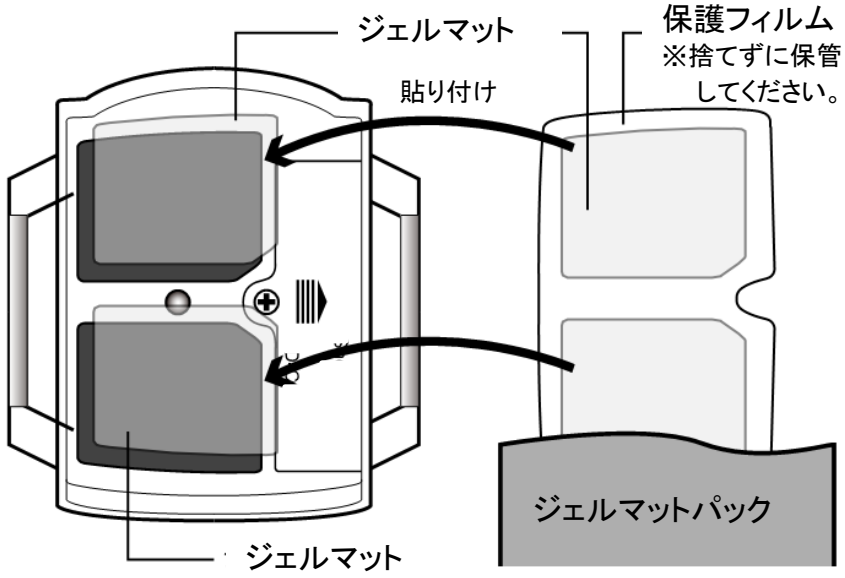
ジェルマット
貼り付け
保護フィルム
※捨てずに保管してください。
ジェルマットパック
ジェルマット

起動操作と調整

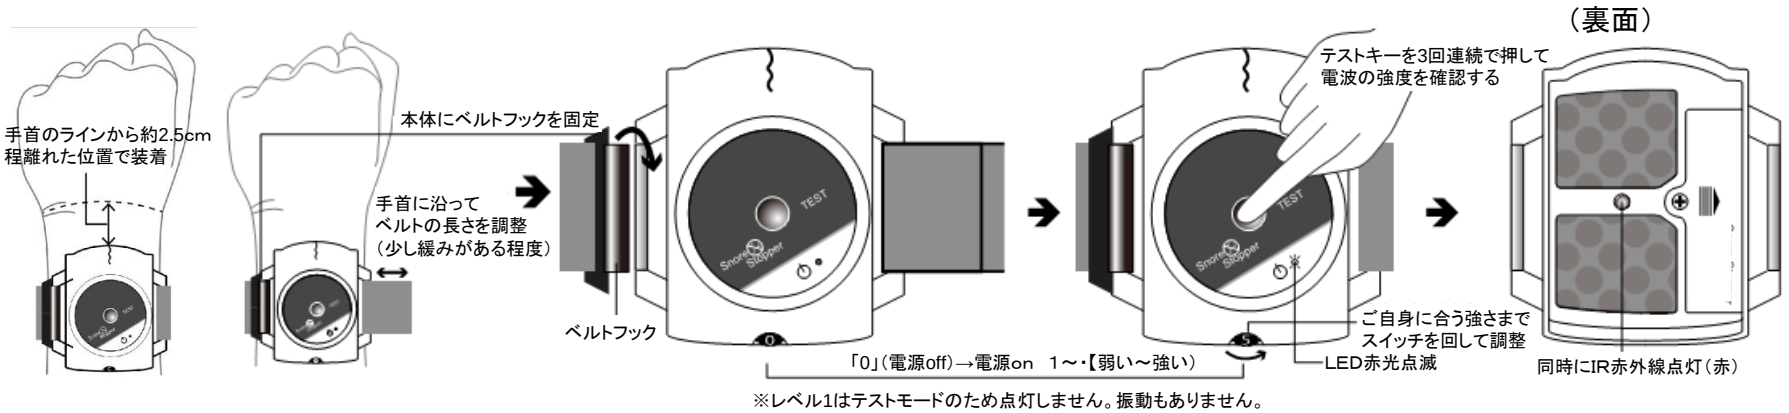

※レベル1はテストモードのため点灯しません。振動もありません。

準備と確認

まず電池を入れます。次に本品の裏面の黒いゴムパッドに、電極パッドの役目をするジェルマットを貼り付けます。（保護フィルムは捨てずに保管してください。）

起動操作と調整

①本体にベルトフックをかけ、ベルトを左或いは右の手首に装着してバンドを締めます。
②電源スイッチ（2～）を入れて、LED指示灯がゆっくり点滅していること（裏面のIR赤外線LEDが赤く点灯）を確認してください。
③電気波動の強さをテストキーで確認します。テストキーを連続3回押すと弱い電気波動が感じられます。レベル2の弱い波動から1段階ずつ波動が強くなります。ご自分の好みに合う波動に設定してご使用ください。
本品は8時間のオートオフタイマーが備えつけられています。準備が完了しましたら、そのまま通常通りに就寝してください。

ご使用にあたって

本品が3回以上のいびき（65dB以上の音を自動感知）を感知すると、弱い電気波動を出力します。すると反射神経により寝る姿勢を変えていびきを止めるように作用します。
※本品がオートオフタイマーの時間（8時間）を経過すると電源が自動に切れ作動が停止します。（再起動する場合は、一度電源スイッチを0に戻してください。
※手動OFFの場合は電源スイッチを0に戻してください。
※2回目以降の着脱はベルトフックで行ってください。バンドの長さ調節が不要になります。

ご使用後

本品使用後は、ジェルマットに保護フィルムを貼って保管してください。
※ジェルマットにゴミが付着すると効果が出ません。

仕　様	
型番	EB-RM1800
商品名	いびきストッパー
サイズ	約W40×H13×D58mm
重量	約50g（本体とベルト）
材質	本体：ABS　　ベルト ：ナイロン
出力強度	180μA
出力方式	0.2Hz固定
出力波形	固定周波数方形波方式出力
電源	単4電池　1本（付属していません。市販別売り）
使用時間	8時間（8時間後オートオフ）
操作環境	温度10度～40度　　湿度30～85%
付属品	ジェルマット1パック、取り付けベルト、プラスミニドライバー、取扱説明書

※仕様は製品の改善・品質向上のため予告無く変更する場合があります。
※各種案内に使用している製品の写真はあくまでもイメージであり、実際の製品と多少異なる場合がございます。

注意事項「必ずお読みください」

※仕様は製品の改善・品質向上のため予告無く変更する場合があります。
※各種案内に使用している製品の写真はあくまでもイメージであり、実際の製品と多少異なる場合がございます。

保証条件の内容

保証期間内でも以下の場合は有料修理となります。
ご確認ください。

●下記の事項
1；誤ったご使用・不当な修理・改造・分解で生じた故障または損傷。

2；お買い上げ後の落下・故意による破損・輸送等で生じた故障または損傷。

3；火災・天災地変・塩害・異常電圧・指定外電圧使用等で生じた故障または損傷。

4；本書の提示がない場合。

5；本書にお買い上げ日・お客様名・販売名の記入がない場合。

6；一般家庭用以外（業務用等）、または異常な連続使用による故障または損傷。

7；使用時に起きた傷・色あせ・汚れ、または保管の不備等で起きた損傷。

8；付属品と消耗品の交換。

●本書（保証書）は日本国内において有効です。

※保証期間中でも保証書のご提示が無い場合、有償修理となる場合があります。
※弊社出張修理サービス等は行っておりません。修理・点検ご希望の際はカスタマーサポートへご相談ください。

商品の修理・検査依頼・万が一の初期不良・不具合・商品説明・
操作方法・荷物確認などの問題が発生した場合は下記電話番号へ

サポートダイヤル

050-5812-0253

東京都中央区日本橋人形町1-11-2 川商ビル4階

[受付時間]平日 9:00～12:00 13:00～17:00(土・日・祝日は除く)

電話集中している場合は、通話が繋がり難い、繋がらない場合もございます。再度、お時間をおいてお掛け直しくださいますようお願い致します。

商品保証書

【商品名】 いびきストッパー EB-RM1800

お買上日	年 月 日	保証期間	3ヶ月(本体のみ)
お客様ご住所	TEL:		
お客様ご芳名	様		
販 売 店	印		

上記商品をお買上げ頂きまして誠に有難うございます。この保証書はお客様の通常のご使用により万一故障した場合には、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

- この保証書をお受取になる時に販売年月日、販売店、取扱者印が記入してあることをご確認下さい。
- 本保証書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管ください。

TEL:050-5812-0253